

met een schaar en UltraTrimm moet de zacht blijvende voering, teneinde de optimale fysieke eigenschappen te bereiken; nogmaals 10 min. in een waterbad met een temperatuur van 35–40 °C gelegd worden. Alternatief kan de prothese ook ca. 20 min. bij kamertemperatuur bewaard worden.

b) Indirecte methode

Door de tandarts met afdrukmateriaal gevormde prothese wordt in een gangbaar apparaat voor voeringen, dan wel in een cuvette geplaatst en na uitname bewerkt zoals in punt 1 en 2 beschreven wordt. Om gedeeltelijke verbindingen tussen silicone en gips te voorkomen, dient het model met een alginaatsolatie (bv. Isolat-film) verzeegd te worden. Met behulp van een applicator wordt MegaBase® nu over het gehele oppervlak basaal en op de voorbereide vestibulaire / orale zones aangebracht. Om luchtbellen te voorkomen, dient MegaBase® ongeveer 1 mm dikker aangebracht te worden dan voor de voering noodzakelijk is. De gecarteerde prothese wordt nu in het voeringsapparaat teruggeplaatst en langzaam en gelijkmatig wordt de druk opgebouwd. De uitharding van de MegaBase®-voering vergt bij kamertemperatuur ongeveer 20 min. Om de vulkanisatie te versnellen, kan de voering ook gedurende ca. 12 min. in een drukkamer of een droger op ca. 40 °C worden gelegd.

De verwerktijden staan vermeld in de tabel "Technische gegevens".

5. Afwerken

Overtollig materiaal kan snel en probleemloos met een scalpel of schaar worden bijgesneden. Voor het daaropvolgende gladmaken strekken toegepaste slipers met verschillende korrelgroottes tot aanbeveling (bv. UltraTrimm medium en siliconenslijpkappen). Let hierbij op lage toerentalen (max. 8000 omw./min) van het handstuk.

6. Lakken

Zie gebruiksaanwijzing MegaBase® 2K Lack.

Desinfectie

De afgewerkte prothese met zacht blijvende voering kan worden ontsmet met ontsmettingsmiddelen voor tandheelkundige siliconen die gewoonlijk in tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria worden gebruikt.

Let op

- MegaBase® mag niet voor conventionele afdrukken gebruikt worden.
- Het product is uitsluitend bestemd voor het genoemde

doeleinden het geschikt is te onderzoeken, vooral ook wanneer deze niet vermeld zijn in de gebruiksaanwijzing.

toepassingsgebied en mag alleen worden gebruikt door professioneel gekwalificeerde en geïnstrueerde personen. Ribasatura morbida per protesi mobili

Indicazione

Per l'utilizzo come materiale di ribasatura molle permanente di protesi rimovibili con metodo diretto o indiretto.

Ambito d'applicazione

- Ribasatura morbida permanente
- Realizzazione di punti di compressione
- Miglioramento dell'effetto ventosa (con creste morbide)
- Copertura protettiva in seguito ad interventi implantologici
- Copertura di creste particolarmente aguzze

Contraindicationi

Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei componenti. Non si prevedono effetti collaterali indesiderati del presente dispositivo medico a trasformazione ed applicazione corrette. In linea di principio non si possono tuttavia escludere reazioni di ipersensibilità (ad es. allergie) o parastesie locali (ad es. irritazioni della mucosa orale). Se si verificano effetti collaterali indesiderati, anche in caso di dubbio, si prega di comunicarci sempre descrivendo più dettagliatamente le circostanze e i sintomi concomitanti. Analizziamo tutte le comunicazioni.

Gruppo di pazienti target

Pazienti per i quali sono necessarie cure odontoiatriche.

Utenti destinatari

Odontoiatra, odontotecnico

Descrizione del prodotto

MegaBase® è un silicone autoindurente ed è adatto sia come materiale per ribasatura diretta che come materiale da laboratorio. Oltre al materiale da ribasatura, il set MegaBase®, è costituito da un ottimo adesivo per una adesione perfetta tra silicone e resine PMMA, ed una lacca a due componenti autopolimerizzabile per la sigillatura superficiale finale.

Lavorazione

1. Preparazione

La protesi deve essere pulita dai residui di saliva e successivamente assicurata. Tutta la zona che deve essere ribasata di approssimativamente 2-3mm nelle aree vestibolari e buccali, deve essere abrasa di circa 1 mm. Le vecchie ribasature devono essere completamente eliminate e i bordi allisciati. Per ottenere un confine più pulito tra la zona ribasata dal silicone e la resina, si consiglia di applicare uno scialino rettangolare nella zona circostante. Le impurità possono ridurre notevolmente il


legame resina / silicone. Ecco perché tutta la protesi deve essere pulita con alcol detergente alla fine della fase di preparazione.

2. Lavorazione dell'adesivo

Stendere 2 strati sottili di adesivo su tutta la zona pulita (a distanza di 30 sec. l'uno dall'altro) su cui poi in seguito si dovrà applicare il MegaBase®. L'essiccazione richiede circa 1:30 min. sec. Ricominciare la lavorazione solo dopo la completa essiccazione dell'adesivo.

3. Lavorazione cartuccia doppia da 50 ml

MegaBase® viene miscelato automaticamente dalla cartuccia doppia in rapporto 1:1. A tale scopo, inserire la cartuccia doppia nell'injector. Rimuovere il tappo e far fuoriuscire un po' di materiale dalla cartuccia doppia, per garantire un'erogazione uniforme dei due componenti. Inserire ora una cannuola di miscelazione sulla cartuccia doppia ed iniziare ad applicare.

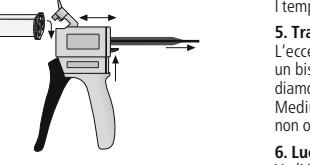

4. Ribasatura

a) Metodo diretto

Preparare la dentiera come descritto ai punti 1 e 2. Quando coprire tutta la parte partendo dai bordi con uno strato di circa 2 mm. Il tempo di lavorazione del MegaBase® è di circa 2:00 min. Applicare tutto il materiale necessario e riposizionare la protesi in bocca. Fino alla scadenza del tempo di lavorazione il paziente deve eseguire tutti i movimenti funzionali. La completa polimerizzazione del MegaBase® avviene in bocca al più tardi dopo 4 min. dopo i quali la protesi può essere rimossa. Prima di rinfriargli (punto 5), trarre le apposite forbici e gli abrasivi UltraTrimm, la ribasatura andrebbe posta in un bagno caldo (35 °C / 40 °C) per circa 10 min. al fine di raggiungere le caratteristiche fisiche ottimali. In alternativa, la protesi può essere lasciata a temperatura ambiente per circa 20 min.

b) Metodo indiretto

La dentiera che deve essere preparata dal dentista con una massa da impronta, va posizionata all'interno di una nor-

male muffola da ribasatura ed in seguito trattata prima della rimozione, come descritto ai punti 1 e 2. Onde evitare ogni possibilità di legame tra silicone e gesso, il modello deve essere inumidito con un isolante a base alginica (Isolat film). Per mezzo del macchinario per la distribuzione il MegaBase® va applicato con uno strato sottile sulle zone preparate vestibolobuccali. Al fine di evitare bolle d'aria, il MegaBase® andrebbe distribuito con uno spessore minimo superiore ad 1 mm. Il valore tissotropico stabile del MegaBase® evita una concentrazione indesiderata di materiale nella zona mandibolare. La protesi così ricoperta va ora posizionata nell'apparecchio per la ribasatura e la pressione deve essere aumentata lentamente e costantemente. La polimerizzazione del MegaBase® necessita di circa 20 min. a temperatura ambiente. Al fine di velocizzare questo processo si può mettere la ribasatura all'interno di una pentola a pressione o in una camera di essiccamiento per circa 12 min. a 40 °C.

Conservare lontano dalla portata dei bambini!

I tempi di lavorazione si trovano nella tabella „dati tecnici“.

5. Trattamento

L'eccesso di materiale può essere facilmente rimosso con un bisturi o con forbici. Per un'ulteriore rinfiratura, raccomandiamo l'uso di ruote abrasive a grana diversa (es. Ultra Trimm Medium) oppure cappette abrasive siliconiche. Si prega di non oltrepassare un regime di rotazione di 8000 giri / min.

6. Lucidatura

Vedi istruzioni MegaBase® 2K Lack.

Disinfezione

La disinfezione della protesi completata con ribasatura molle può essere eseguita con disinfettanti per siliconi dentali comunemente impiegati negli ambulatori odontoiatrici e nei laboratori odontotecnici.

Attenzione!

- Non utilizzare MegaBase® per impronte convenzionali.
- Il prodotto è predisposto unicamente per l'ambito di utilizzo indicato e deve essere utilizzato soltanto da specialisti qualificati e opportunamente istruiti.

- A causa di motivi tecnici di produzione è possibile che all'utilizzo di una nuova cartuccia, all'inizio, si verifichi una fuoriuscita irregolare dei componenti. Per questo motivo s'invita a non utilizzare la prima quantità, estremamente ridotta, del materiale fuoriuscito.
- Pre-trasportare il materiale prima di inserire la cannuola di miscela.

- Non lasciare residui del materiale in bocca.

Lieferform / Form of delivery / Forme de livraison / Forma de entrega / Forma de entrega / Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios / Accessori / Accessórios / Material entregue

MegaBase® Starter Kit

50 ml		REF D5038223
6 x		

50 ml		REF D5038220NA
6 x		

10 ml		REF D49701X3
2 x		

DS 50		REF D5007
1 x		

12 x		D43752
1 x		

2 x 50 ml		REF D5038223NR
5 x		

Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios / Accessori / Accessórios / Material entregue

MegaBase® 2K Lack

2 x 50 ml		REF D38233
12 x		

MegaBase® Adhäsiv		REF D5038220NA
10 ml		

100		REF D49701X3
40		

DS 50		REF D5007
1 x		

MegaBase® Silikon		D4462
2 x 50 ml		

MegaBase®

Gebrauchsanweisung

Directions for use

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Instruções de uso

Dreve Design Rev. 24622-3596

Zweckbestimmung

Weiches Prothesenunterfütterungsmaterial

Indikation

Zur Verwendung als langfristiges weiches Unterfütterungsmaterial für herausnehmbare Prothesen durch die direkte oder indirekte Methode.

Anwendungsbereich

- Permanente weichbleibende Unterfütterung
- Entlastung dauernder Druckstellen
- Verbesserung des Saugeffektes (Schlotterkamm)
- Schutzabdeckung nach Implantologischer Versorgung
- Abdeckung scharfkantiger Knochenanteile

Kontraindikation

Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht angewendet werden. Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen (z. B. Reizungen des Mundschleimhaut) können jedoch prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome. Wir gehen jedem Hinweis nach.

Patientenzielgruppe

Patienten, für die eine Zahnversorgung notwendig ist.

Vorgesetzter Anwender

Zahnarzt (m/w/d), Zahntechniker (m/w/d)

Produktbeschreibung

MegaBase® ist ein autopolymerisierendes Silikon und eignet sich sowohl als direktes Unterfütterungsmaterial als auch als Labormaterial. Zum MegaBase®-Set gehören neben dem Unterfütterungsmaterial ein Adhäsiv für den festen Verbund zwischen Silikon und PMMA-Kunststoff sowie ein selbst-härtender Zwei-Komponenten-Lack zur abschließenden Glanzbeschichtung.

Verarbeitung

1. Vorbereitende Maßnahmen

Die Prothese muss von Speichelresten gesäubert und anschließend getrocknet werden. Der gesamte basale zu unterfütternde Bereich sowie ca. 2-3 mm der vestibulären / buccalen Flächen werden etwa um 1 mm Stärke zurückgeschliffen. Alle


Unterfütterungen müssen komplett entfernt und die Prothesenränder abgerundet werden. Für einen sauberen Übergang von Silikon zum Prothesenkunststoff sollte eine umlaufende, rechtwinklige Stufe eingearbeitet werden. Verunreinigungen können den Silikon / Kunststoff-Verbund erheblich mindern. Deshalb zum Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen die gesamte Prothese mit einem alkoholischen Reinigungsmittel säubern und entfetten.

b) Indirekte Methode

Auf alle beschliffenen, sauberen Bereiche der Prothese, an denen MegaBase® haften soll, wird im Abstand von ca. 30 Sek. 2 x gleichmäßig dünn und flächendeckend das Adhäsiv aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt etwa 1:30 Min. Erst weiterarbeiten, wenn das Adhäsiv komplett abgetrocknet ist.

3. Verarbeitung 50 ml Kartusche

MegaBase® wird aus der Doppelkartusche automatisch im Verhältnis 1:1 gemischt. Setzen Sie dazu die Doppelkartusche in den Injector ein. Entfernen Sie die Verschlusskappe und füllen Sie ein wenig Material aus der Doppelkartusche, um ein gleichmäßiges Austreten der Komponenten zu gewährleisten. Nun setzen Sie eine Mischkanüle auf die Doppelkartusche auf und beginnen Sie mit dem Auftragen.

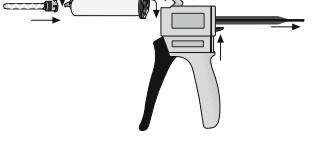

4. Unterfütterung

a) Direkte Methode

Die Prothese wird wie in Punkt 1 und 2 beschrieben vorbereitet. Anschließend die gesamte Basis von den Prothesenrändern ausgängig mit einer minimalen Materialstärke von 2 mm beschichten. Zum anschließenden Glätten empfehlen sich rotierende Schleifkörper mit unterschiedlichen Körnungen (z. B. UltraTrimm medium oder Silikonschleifkappen). Bitte achten Sie hierbei auf niedrige Drehzahlen (max. 8000 U/min.) des Handstückes.

6. Lackieren

Siehe Anleitung MegaBase® 2K Lack.

Desinfektion

Die Desinfektion der fertiggestellten Prothese mit weichbleibender Unterfütterung kann mit in Zahnarztpraxen und zahntechnischen Labor gebrauchten Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden.

fortgeschritten, dass die Prothese ausgeliert werden kann. Vor der Nachbearbeitung (siehe Abschnitt 5) mit Schere und UltraTrimm sollte die weichbleibende Unterfütterung zur Erreichung der optimalen physikalischen Eigenschaften für weitere 10 Min. in ein Wasserbad mit einer Temperatur von 35–40°C eingelagert werden. Alternativ kann die Prothese auch für ca. 20 Min. bei Raumtemperatur gelagert werden.

a) Indirekte Methode

Die vom Zahnarzt mit Abformmasse vorbereitete Prothese wird in ein handelsübliches Unterfütterungsgerät bzw. in eine Kuvette eingesetzt und nach der Entnahme aus dem Rebarber-Gerät verarbeitet. Verunreinigungen können den Silikon / Kunststoff-Verbund erheblich mindern. Deshalb zum Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen die gesamte Prothese mit einem alkoholischen Reinigungsmittel säubern und entfetten.

2. Verarbeitung des Haftvermittlers

Auf alle beschliffenen, sauberen Bereiche der Prothese, an denen MegaBase® haften soll, wird im Abstand von ca. 30 Sek. 2 x gleichmäßig dünn und flächendeckend das Adhäsiv aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt etwa 1:30 Min. Erst weiterarbeiten, wenn das Adhäsiv komplett abgetrocknet ist.

3. Verarbeitung 50 ml Kartusche

MegaBase® wird aus der Doppelkartusche automatisch im Verhältnis 1:1 gemischt. Setzen Sie dazu die Doppelkartusche in den Injector ein. Entfernen Sie die Verschlusskappe und füllen Sie ein wenig Material aus der Doppelkartusche, um ein gleichmäßiges Austreten der Komponenten zu gewährleisten. Nun setzen Sie eine Mischkanüle auf die Doppelkartusche auf und beginnen Sie mit dem Auftragen.

Achtung

• MegaBase® darf nicht für konventionelle Abformungen eingesetzt werden.

• Das Produkt ist ausschließlich für den genannten Einsatzbereich bestimmt und ist nur von fachlich qualifizierten und eingewiesenen Personen zu verwenden.

• Aus produktionstechnischen Gründen kann bei einer neuen Kartusche anfangs eine ungleichmäßige Förderung der Komponenten auftreten. Aus diesem Grund sollte die erste geförderte – etwa ergangsgröße – Menge nicht verwendet werden.

• Vor Aufsetzen der Mischkanüle das Material vorfordern.

• Keine Reste des Materials im Mund belassen.

• Die Polymerisation, also das Abbinden von additiv-verfestigten Silikonen, kann durch Latexhandschuhe, Cremes, Kunststoffe, Reinigungsmittel usw. gestört werden. Wir empfehlen daher das Tragen von handschuhähnlichen Polyethylenhandschuhen.

• Schutzbekleidung tragen! Abgebundenes Material ist chemisch beständig. Flecken auf der Kleidung können nicht entfernt werden.

• Beim Nachbearbeiten des ausgehärteten Materials entsprechend geeignete, persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbille, Mundschutz) tragen.

• Nach Gebrauch Mischkanüle als Verschluss auf Doppelkartusche belassen.

• Nie gegen eine ausgehärtete Mischkanüle fördern.

Intended use

Soft denture relining resin

Indication for use

To be used as long-term soft relining material for removable dentures by direct or indirect method.

Fields of application

- Permanent soft relining
- Relief of permanent pressure spots
- Improvement of the suction effect (flabby ridge)
- Protective cover following implants
- Cover for sharp-edged bone parts

Contraindication

The product may not be used if the patient is allergic to one of the ingredients. There are no side-effects to be expected from this medical device if processed and used properly. However, immune reactions (e.g. allergies) or local disorders of sensation (e.g. irritation of the oral mucosa) cannot be ruled out in principle. If you become aware of adverse side-effects, also in cases of doubt, please be sure to advise us in any case and describe the circumstances and symptoms as accurately as possible. We will investigate any notice.

Please find processing times in "technical data" overview.

5. Treatment

Excess material can be quickly and easily cut off with a scalpel or scissors. We recommend the use of rotating grinding wheels with different grain sizes (e.g. UltraTrimm medium or silicone abrasive heads) for subsequent smoothing. Please make sure the handpiece is at low speed (max. 8000 rpm).

Hazard identification

Hazard and safety notes can be found on the product label and the corresponding safety data sheet.

Keep away from children!

Note for one-time use

Due to the physical characteristics, the cured prosthesis relining material cannot be used for further lining or relining.

Disposal

Disposal of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations and safety data sheet.

Hazard identification

Hazard and safety notes can be found on the product label and the corresponding safety data sheet.

Serious incidents

All serious incidents occurring in relation to the product shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is settled.

Groupe de patients cible

Les patients qui ont besoin d'une restauration dentaire.

Utilisateurs visés

Dentiste, prothésiste dentaire

Description du produit

MegaBase® est un silicium autopolymerisant conçu pour être utilisé aussi bien à titre de matériau de rebasage direct qu'à titre de matériau de laboratoire. Outre le matériau de rebasage, le kit MegaBase® comprend également un adhésif pour une adhérence solide entre le silicium et les plastiques PMMA ainsi qu'un vernis bicomposant auto-durcissant pour un revêtement final brillant.

Traitement

1. Mesures préparatoires

La prothèse doit être débarrassée des résidus de salive, puis séchée. L'ensemble de la partie basale à rebaser, ainsi qu'environ 2-3 mm des faces vestibulaires / buccales, doivent être meulés.

Chargennummer / Haltbarkeitsdatum

Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich sowohl auf der Außenverpackung als auch auf dem Produkt. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf

Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, besonders wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen.

This product was developed for dental use and has to be applied according to the instructions. In the case of damages resulting from ulterior or improper use, the manufacturer assumes no liability. Furthermore the user is bound to check the product according to suitability and possible use in self dependence before using it subject to its purpose, especially in case the purpose is not mentioned in the instructions.

the product according to suitability and possible use in self dependence before using it subject to its purpose, especially in case the purpose is not mentioned in the instructions.

Numéro de lot / date de péremption

Le numéro de lot et la date de péremption se trouvent non seulement sur chaque emballage extérieur, mais également sur le produit. En cas de réclamation sur le produit, prière de toujours indiquer le numéro de lot. N'utilisez pas le produit une fois la date de péremption dépassée.

4. Rebasage

a) Méthode directe

Préparer la prothèse comme décrit aux paragraphes 1 et 2. Puis, recouvrir l'ensemble de la base avec le matériau sur une épaisseur minimale de 2 mm, en partant des bords de la prothèse. Le temps de manipulation de MegaBase® est d'environ 2:00 min. Appliquer le matériau complètement l'insérer immédiatement dans la bouche. Jusqu'à la fin du temps de manipulation, le patient exécute tous les mouvements fonctionnels essentiels en occlusion normale. Au bout de 4 min, la vulcanisation de MegaBase® est suffisamment avancée pour permettre de retirer

la prothèse. Avant de procéder aux finitions (point 5) avec des ciseaux et UltraTrimm, le rebasage souple doit être placé pendant 10 min dans un bain-marie d'une température de 35 à 40 °C, afin d'obtenir des propriétés physiques optimales. Alternativement, la prothèse peut être laissée 20 min à température ambiante.

b) Méthode indirecte

Une fois préparée avec une pâte d'empreinte par le dentiste, la prothèse est placée dans un appareil de rebasage en usage dans le commerce ou dans une cuvette. Elle doit ensuite être manipulée comme décrit aux paragraphes 1 et 2. Afin d'éviter des liaisons partielles entre la silicium et le plâtre, il convient d'appliquer une isolation d'alginate (p. ex. Isolat film). A l'aide d'un appareil d'injection, MegaBase® est alors appliquée en couche mince et courante au niveau basal, ainsi que sur les faces vestibulaires / orales. Pour éviter la formation de bulles d'air, il convient d'appliquer MegaBase® en une couche 1 mm épaisseur par rapport à celle nécessaire pour le rebasage. La prothèse enduite est alors remplacée dans l'appareil de rebasage et la pression doit être augmentée de manière lente et constante. Le durcissement du matériau de rebasage MegaBase® nécessite environ 20 min à température ambiante. Afin d'accélérer la vulcanisation, il est possible de placer le matériau de rebasage dans une autoclave ou dans une armoire de séchage à 40 °C pendant env. 12 min.

Les temps de procédure sont indiqués dans le tableau avec des "données techniques".

Conserver hors de la portée des enfants !

Remarque sur un usage unique

Le surplus de matériau peut être coupé rapidement et sans problème avec un scalpel ou des ciseaux. Pour une finition lisse, nous recommandons l'emploi de têtes abrasives rotatives avec des grains différents (p. ex. UltraTrimm medium ou des capuchons abrasifs pour silicium). Veillez utiliser un nombre faible de tours (max. 8000 tours / min.) de la pièce à main.

5. Definitions

Le surplus de matériau peut être coupé rapidement et sans

problème avec un scalpel ou des ciseaux. Pour une finition lisse,

nous recommandons l'emploi de têtes abrasives rotatives avec

des grains différents (p. ex. UltraTrimm medium ou des capuchons

abrasifs pour silicium). Veillez utiliser un nombre faible de

tours (max. 8000 tours / min.) de la pièce à main.

Attention

• Ne pas utiliser MegaBase® pour des empreintes conventionnelles.

• Voir le mode d'emploi MegaBase® 2K Lack (vernis).

Désinfection

La désinfection de la prothèse实现 avec rebasage souple peut être réalisée à l'aide des désinfectants pour silicium traditionnellement utilisés dans les cabinets et laboratoires dentaires.

Incidents graves

Tous les incidents graves apparus en rapport avec le produit doivent être signalés au fabricant et aux autor